

Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione della fornitura di POMPE INFUSIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI E POMPE ELASTOMERICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER ORAS S.p.A.

VERBALE DEL 26/01/2024

Il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 2024, alle ore 09:00, si è riunita la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a mezzo procedura aperta telematica per la fornitura di POMPE INFUSIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI E POMPE ELASTOMERICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER ORAS S.p.A., nominata con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n.272 del 04/05/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero sopra menzionata, risulta così composta:

Presidente:

- Dott. Nicolò Sella – Dirigente Medico UOC Istituto Anestesia e Rianimazione in servizio presso Azienda Ospedale-Università Padova;

Componenti:

- Dott. Luigi Trevisi – Infermiere Professionale Cure Primarie Distretto di Treviso – Sede di Casale sul Sile in servizio presso l'ULSS 2 Marca Trevigiana;
- Ing. Davide Perli – Ingegnere clinico in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;
- Dott. Gianpaolo Franzoso – Dirigente Farmacista in servizio presso l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. Padova;
- Dott. Alessandro Pegoraro Coordinatore infermieristico Gruppo Operatorio in servizio presso l'ULSS 6 Euganea;

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti in presenza dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal personale in servizio presso la U.O.C. CRAV nella persona del Dott. Enrico Salvalaggio.

Alle ore 9:00 dichiarando aperta la seduta la Commissione Giudicatrice prosegue con la visione dei prodotti offerti e con l'analisi della documentazione di gara afferente.

La Commissione, in seguito alla lettura delle schede tecniche, decide di chiedere i seguenti chiarimenti:

Ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO:



Lotto n. 2 “SISTEMA A CIRCUITO CHIUSO AMBRATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ONCOLOGICI TRAMITE POMPA COSTITUITO DA DEFLUSSORI E DISPOSITIVI PER L’ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE”.

- Si chiede di chiarire, anche al fine della relativa valutazione qualitativa, in quale punto della documentazione tecnica presentata sia possibile evincere la caratteristica del dispositivo offerto relativamente alla possibilità di “Garantire lo scorrimento regolare di tutti i tipi di preparati galenici magistrali oncologici”, come richiesto.

Viene inoltre richiesta la trasmissione anche del seguente ulteriore chiarimento, sempre con specifico riferimento all’operatore economico in parola e al medesimo lotto di gara n. 2 ed in dettaglio:

- Si chiede di chiarire, anche al fine della relativa valutazione qualitativa, in quale punto della documentazione tecnica presentata sia possibile evincere la caratteristica del dispositivo offerto relativamente ad “avere un effetto barriera per fonti luminose che blocchi in modo selettivo le lunghezze d’onda responsabili dell’inattivazione di eventuali sostanze fotosensibili, come richiesto.

La Commissione, nell’impossibilità di terminare i lavori, alle ore 13:00 conclude le operazioni odierne; il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 09:00 del 16/02/2024.

La Commissione di gara.

IL PRESIDENTE: Dott. Nicolò Sella
I COMPONENTI: Dott. Luigi Trevisi
Dott. Alessandro Pegoraro
Dott. Davide Perli
Dott. Gianpaolo Franzoso

Il Segretario verbalizzante:

Dott. Enrico Salvalaggio

The block contains five handwritten signatures, each written over a horizontal line. From top to bottom, they correspond to: Nicolò Sella, Luigi Trevisi, Alessandro Pegoraro, Davide Perli, and Gianpaolo Franzoso. Below these, there is a sixth signature, which corresponds to the secretary, Enrico Salvalaggio.

Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione della fornitura di **POMPE INFUSIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI E POMPE ELASTOMERICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER ORAS S.p.A.**

VERBALE DEL 16/02/2024

Il giorno 16 del mese di febbraio dell'anno 2024, alle ore 09:00, si è riunita la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a mezzo procedura aperta telematica per la fornitura di POMPE INFUSIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI E POMPE ELASTOMERICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER ORAS S.p.A., nominata con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n.272 del 04/05/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero sopra menzionata, risulta così composta:

Presidente:

- Dott. Nicolò Sella – Dirigente Medico UOC Istituto Anestesia e Rianimazione in servizio presso Azienda Ospedale-Università Padova;

Componenti:

- Dott. Luigi Trevisi – Infermiere Professionale Cure Primarie Distretto di Treviso – Sede di Casale sul Sile in servizio presso l'ULSS 2 Marca Trevigiana;
- Ing. Davide Perli – Ingegnere clinico in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;
- Dott. Gianpaolo Franzoso – Dirigente Farmacista in servizio presso l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. Padova;
- Dott. Alessandro Pegoraro Coordinatore infermieristico Gruppo Operatorio in servizio presso l'ULSS 6 Euganea, in collegamento da remoto via GoogleMeet;

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti in presenza o mediante collegamento informatico (GoogleMeet) attivato da Azienda Zero mediante invito riservato trasmesso alla mail di servizio personale, dichiara aperta la seduta.

La Commissione, preliminarmente, prende atto delle risposte pervenute ai chiarimenti richiesti come disposto nel verbale del 26/01/2024 all'operatore economico FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO, ed in particolare:

- Chiarimento n.1: Si chiede di chiarire in quale punto della documentazione tecnica presentata sia possibile evincere la caratteristica del dispositivo offerto relativamente alla possibilità di "Garantire lo scorrimento regolare di tutti i tipi di preparati galenici magistrali oncologici", come richiesto.

Dopo approfondita lettura della risposta trasmessa, si conferma che il prodotto proposto risulta conforme a quanto richiesto e rispettoso delle caratteristiche minime poste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico.

- Chiarimento n.2: Si chiede di chiarire in quale punto della documentazione tecnica presentata sia possibile evincere la caratteristica del dispositivo offerto relativamente ad *“Avere un effetto barriera per fonti luminose che blocchi in modo selettivo le lunghezze d’onda responsabili dell’inattivazione di eventuali sostanze fotosensibili”*, come richiesto.

Dopo approfondita lettura della risposta trasmessa, si rileva che il prodotto proposto al lotto di gara n. 2 non risulta conforme a quanto richiesto in quanto non ottempera alle caratteristiche minime poste a pena di esclusione dal Capitolato Tecnico. Nello specifico il lotto in oggetto richiede la presentazione di un *“SISTEMA A CIRCUITO CHIUSO AMBRATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ONCOLOGICI TRAMITE POMPA COSTITUITO DA DEFLUSSORI E DISPOSITIVI PER L’ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE”*, con l’esplicita succedanea indicazione di carattere generale che viene qui riproposta per completezza:

“I set dovranno inoltre: [...] avere un effetto barriera per fonti luminose che blocchi in modo selettivo le lunghezze d’onda responsabili dell’inattivazione di eventuali sostanze fotosensibili”.

Tale caratteristica non risulta rinvenibile sul prodotto cod. M77460070Y proposti dalla ditta in parola e la lettura della documentazione tecnica presentata ne assevera il difetto con la chiara indicazione di divieto di utilizzo con farmaci fotosensibili. Si evidenzia dunque che il chiarimento pervenuto non appare dirimente rispetto a quanto qui rilevato e viene ritenuto pertanto non soddisfacente.

Ciò stante il Presidente trasmette quanto qui riportato al RUP di Gara per gli adempimenti di competenza.

Successivamente la Commissione Giudicatrice prosegue con la visione dei prodotti offerti e con l’analisi della documentazione di gara afferente.

La Commissione, nell’impossibilità di terminare i lavori, alle ore 13:30 conclude le operazioni odierne; il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 09:00 del 05/03/2024.

La Commissione di gara.

IL PRESIDENTE:

Dott. Nicolò Sella


I COMPONENTI:

Dott. Luigi Trevisi

Dott. Alessandro Pegoraro


Dott. Davide Perli

Dott. Gianpaolo Franzoso

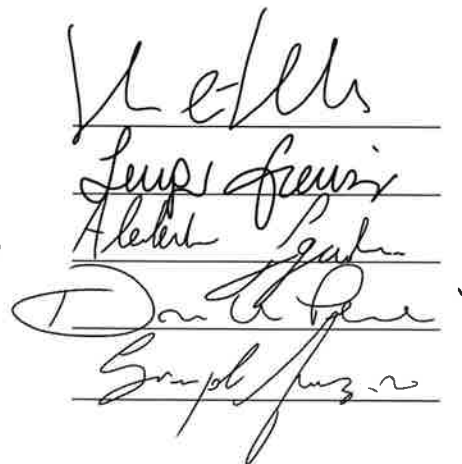

Il Segretario verbalizzante:

Dott. Enrico Salvalaggio

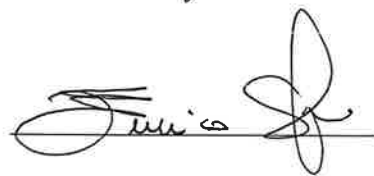

Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione della fornitura di POMPE INFUSIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI E POMPE ELASTOMERICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER ORAS S.p.A.

VERBALE DEL 05/03/2024

Il giorno 05 del mese di marzo dell'anno 2024, alle ore 09:00, si è riunita la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a mezzo procedura aperta telematica per la fornitura di POMPE INFUSIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI E POMPE ELASTOMERICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER ORAS S.p.A., nominata con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n.272 del 04/05/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero sopra menzionata, risulta così composta:

Presidente:

- Dott. Nicolò Sella – Dirigente Medico UOC Istituto Anestesia e Rianimazione in servizio presso Azienda Ospedale-Università Padova;

Componenti:

- Dott. Luigi Trevisi – Infermiere Professionale Cure Primarie Distretto di Treviso – Sede di Casale sul Sile in servizio presso l'ULSS 2 Marca Trevigiana, in collegamento da remoto via GoogleMeet;
- Ing. Davide Perli – Ingegnere clinico in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona;
- Dott. Gianpaolo Franzoso – Dirigente Farmacista in servizio presso l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. Padova, in collegamento da remoto via GoogleMeet;
- Dott. Alessandro Pegoraro Coordinatore infermieristico Gruppo Operatorio in servizio presso l'ULSS 6 Euganea, in collegamento da remoto via GoogleMeet;

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti mediante collegamento informatico (GoogleMeet) attivato da Azienda Zero mediante invito riservato trasmesso alla mail di servizio personale, dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal personale in servizio presso la U.O.C. CRAV nella persona del Dott. Enrico Salvalaggio.

Alle ore 9:00 dichiarando aperta la seduta la Commissione Giudicatrice prosegue con l'analisi della documentazione di gara afferente.

La Commissione, nell'impossibilità di terminare i lavori, alle ore 13:00 conclude le operazioni odierne; il Presidente dichiara chiusa la seduta e, sentiti i presenti, aggiorna i lavori alle ore 09:00 del 25/03/2024.

La Commissione di gara.

IL PRESIDENTE:

Dott. Nicolò Sella


I COMPONENTI:

Dott. Luigi Trevisi

Dott. Alessandro Pegoraro

Dott. Davide Perli


Dott. Gianpaolo Franzoso

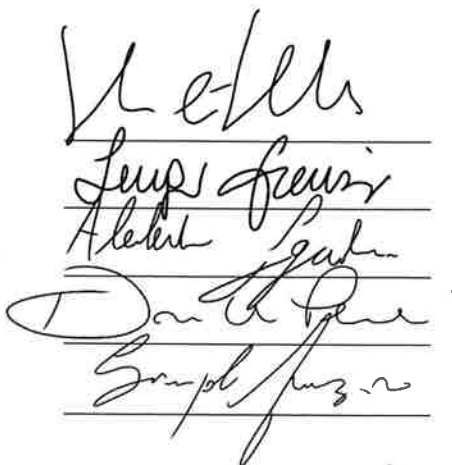

Handwritten signatures of the commission members: Nicolò Sella, Luigi Trevisi, Alessandro Pegoraro, Davide Perli, and Gianpaolo Franzoso.

Il Segretario verbalizzante:

Dott. Enrico Salvalaggio

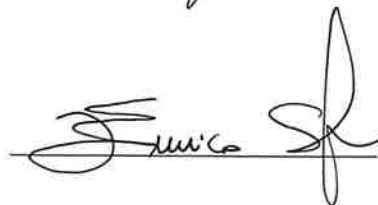

Handwritten signature of the secretary, Dott. Enrico Salvalaggio.

Procedura aperta telematica per l'aggiudicazione della fornitura di **POMPE INFUSIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI E POMPE ELASTOMERICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER ORAS S.p.A.**

VERBALE DEL 25/03/2024

Il giorno 25 del mese di marzo dell'anno 2024, alle ore 09:00, si è riunita la Commissione Giudicatrice, incaricata della valutazione dal punto di vista tecnico ed economico delle offerte presentate dai concorrenti ammessi alla gara d'appalto a mezzo procedura aperta telematica per la fornitura di POMPE INFUSIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI E POMPE ELASTOMERICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER ORAS S.p.A., nominata con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero n.272 del 04/05/2023.

La Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale di Azienda Zero sopra menzionata, risulta così composta:

Presidente:

- Dott. Nicolò Sella – Dirigente Medico UOC Istituto Anestesia e Rianimazione in servizio presso Azienda Ospedale-Università Padova, in collegamento da remoto via GoogleMeet;

Componenti:

- Dott. Luigi Trevisi – Infermiere Professionale Cure Primarie Distretto di Treviso – Sede di Casale sul Sile in servizio presso l'ULSS 2 Marca Trevigiana, in collegamento da remoto via GoogleMeet;
- Ing. Davide Perli – Ingegnere clinico in servizio presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, in collegamento da remoto via GoogleMeet;
- Dott. Gianpaolo Franzoso – Dirigente Farmacista in servizio presso l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.S.S. Padova, in collegamento da remoto via GoogleMeet;
- Dott. Alessandro Pegoraro Coordinatore infermieristico Gruppo Operatorio in servizio presso l'ULSS 6 Euganea, in collegamento da remoto via GoogleMeet;

Il Presidente, constatata la presenza di tutti i componenti mediante collegamento informatico (GoogleMeet) attivato da Azienda Zero attraverso l'invito riservato trasmesso alla mail di servizio personale, dichiara aperta la seduta.

Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da personale in servizio presso la U.O.C. CRAV nelle persone del Dott. Enrico Salvalaggio e del Dott. Stefano Peripoli.

A seguito di accurata analisi di tutti gli elementi oggetto di valutazione, sulla scorta dei lavori svolti nel corso delle precedenti sedute, la Commissione procede con la formulazione definitiva dei giudizi di valutazione qualitativa effettuati singolarmente da ciascun componente e dei conseguenti punteggi, come disposto dall'art. 16.2 del Disciplinare di gara, nei termini riportati di cui all'**Allegato A**, che forma parte integrante e sostanziale al presente verbale, limitatamente ai lotti di gara nn. 2, 3 e 4.

La Commissione richiama inoltre il verbale della seduta 16/02/2024, con particolare riferimento all'esclusione dal lotto di gara n. 2 della ditta FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO.

La Commissione Giudicatrice inserisce, quindi, sulla piattaforma Sintel il punteggio tecnico finale riparametrato, ove necessario, attribuito agli operatori economici partecipanti con riferimento a tutti i lotti di gara, le cui risultanze sono riepilogate nel prospetto allegato al presente verbale **Allegato A**.

Viene comunicato a tutti gli operatori economici, tramite l'apposita sezione e come previsto dal Disciplinare di Gara l'apertura delle buste economiche. Si procede, quindi, con le operazioni di apertura e download delle offerte economiche presentate dai concorrenti, tenuto conto che tutte le ditte partecipanti sono risultate conformi alle caratteristiche tecniche minime stabilite nel Capitolato Tecnico e hanno totalizzato un punteggio di qualità, relativo a ciascun singolo gruppo di parametri, superiore alla soglia minima.

Successivamente la Commissione procede quindi per i lotti in parola:

- alla verifica della regolarità formale e sostanziale ed al controllo di assenza di errori di calcolo;
- alla presa d'atto dei punteggi relativi all'elemento economico calcolati dal Sistema;
- alla formulazione della graduatoria finale sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente (dato dalla sommatoria tra il punteggio assegnato alla qualità e il punteggio assegnato all'elemento economico);
- ad individuare, attraverso il Sistema, che consente di evidenziare la soglia di anomalia, le offerte che presentano carattere anormalmente basso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice nonché indica in ogni caso al RUP le offerte che, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 6 del medesimo Codice appaiono, sulla base di elementi specifici, potenzialmente anomale;
- a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta.

Le risultanze complessive delle operazioni compiute nella seduta odierna, secondo quanto disposto dal Disciplinare di gara, sono riepilogate nell'**Allegato B** al presente verbale.

La Commissione Giudicatrice, quindi, propone di aggiudicare la gara d'appalto, mediante procedura aperta telematica per la fornitura di POMPE INFUSIONALI E RELATIVI DEFLUSSORI E POMPE ELASTOMERICHE IN FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO, PER L'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER ORAS S.p.A. nei termini precisati nel precitato **Allegato B**.

Alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta e procede con la consegna al R.U.P. dei verbali predisposti dalla Commissione Giudicatrice, ivi compreso il presente, per gli adempimenti di competenza.

La Commissione di gara.

IL PRESIDENTE:

Dott. Nicolò Sella


I COMPONENTI:

Dott. Luigi Trevisi

Dott. Alessandro Pegoraro

Dott. Davide Perli


Dott. Gianpaolo Franzoso

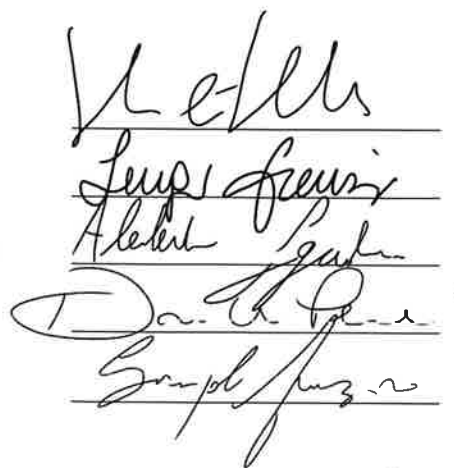

Il Segretario verbalizzante:

Dott. Enrico Salvalaggio

Dott. Stefano Peripoli

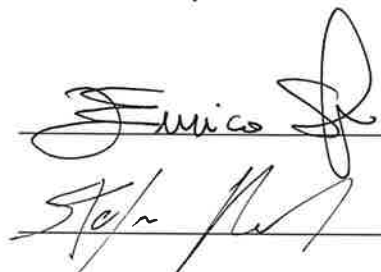

ASSEGNAZIONE IN ACCORDO QUADRO SENZA PERCENTUALE MINIMA DI ASSEGNAZIONE

LOTTO 2 (sub A + sub B + sub C + sub D + sub E): SISTEMA A CIRCUITO CHIUSO AMBRATO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ONCOLOGICI TRAMITE POMPA COSTITUITO DA DEFLUSSORI E DISPOSITIVI PER L'ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE

[illegible]

Giudizio	Coefficiente
Eccellente	1
Eccellente	0,9
Molto buono	0,8
Buono	0,7
Altamente buono	0,6
Sufficiente	0,5
Scarsa	0,4
Molto scarsa	0,3
Inadeguato	0,2
Molto inadeguato	0,1
Assolutamente inadeguato	0

	A-13	
Gualit�	Mantenimento	Punti
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia la presenza di corrosione nei pressi di A.C.G. ma anche la possibilit� del metallo aggredito a causa di assente di mangia ingiallita. Rivista la presenza di supporti per l'interata.	3,2
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia il rivestito grigio #73 montato su pannello a pulvisce e conseguente la gestione del personale delle porte metalliche non ricche nel dispositivo non connesso con chiavi e connesso con chiavi. Il sistema di protezione antirullo � attivato automaticamente al polverizzazione.	4,5
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia la pressione di occlusione su 13 filetti da 10 a 130 gPa.	5,4
Eccellente	0,1-20 m/h incremento di 0,01 m/h	4
Buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia la presenza di acqua da 200 litri fino a 800 litri fiamma in libreria. Il tutto viene considerato come pi� che adeguato.	4
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia il display di colori, non touch screen che si ritiene di non immediate e aggrate lettura. L'etichetta relativa alla pressione di occlusione in quanto appare di piccole dimensioni. Il tutto viene considerato come pi� che adeguato.	4
Buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia la durata della batteria su circa 25 m/h e la resistenza completa ancora in circa 10 sec con pompa accesa 3,5 km	3,5
Eccellente	pilozimino 5%	5,4
Molto scarso	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia che la pompa non � stata di prima re impiegata a necessita di sostituzione. Il software richiesto dal parametro non � validato poich� nella documentazione tecnica non � presente una brochure descrittiva senza dettagliare specifiche tecniche e la connettivit� se � opzionale.	1,5
Critica	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia tutto il segnalibro collegato ai consumabili forati.	6
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia non si segnalibro collegato al consumabile.	7
Buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala la presenza di un 9 integrato nella pompa e sovrappeso per visualizzazione da tempo della funzionalit� delle pompe. Si evidenzia inoltre che il sistema di sicurezza per l'apertura in emergenza della sportello della pompa risulta difficilmente accessibile in situazione di emergenza.	4,2
Inadeguato	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala tutto ci� che non � stato documentato dalla DNDI della presenza di un 9 integrato nella pompa e sovrappeso per visualizzazione da tempo della funzionalit� delle pompe. L'assistenza fu r� a forma mediante il paramentro demanifestato � differenziale.	1,2

Dott. 1		Dott. 2		Dott. 3	
0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90
0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
0.20	0.20	0.20	0.20	0.20	0.20

REGIONE LIGURIA			REGIONE LIGURIA		
Qualifica	RECTOR REGIONIS ITALIA S.P.A.				Punti
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia le dimensioni di 140 mm per 140 mm per 220 mm. Peso 2.8 kg compendio di maniglia alimentare e Positiva la presenza di maniglia integrata.				3,2
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia il grigio 973 e per quanto riguarda la pulizia si evidenzia che la parte centrale dei bracci non ricopre la guaina protettiva.				5
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia che i livelli di pressione di influenza disponibili sono 8, da circa 90 (12 MPa) a 600 (103 MPa) (min).g.				4,8
Eccellente	XVO da 0,1 m/s a 20 m/s configurabile.				4
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro dal parametro si evidenziano i 100.000 eventi registrabili e i 2.000 fermi in libreria.				4,5
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia il display senza disattivo non a colori, i caratteri chiari e informazioni ben definite, nome farmaco visualizzato fino a 20 caratteri.				4
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia la durata della batteria a 2,5 mesi. 1 ore. Tempo di ricarica: 2 ore e mezza.				4
Eccellente	pilissimo 5%.				5,4
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala la presenza di un kit integrato nella pompa e software per visualizzazione da remoto delle funzionalità delle pompe.				4,5
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro non si segnalano criticità in merito ai consumi forniti.				6
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro non si segnalano criticità in merito ai consumi forniti.				7
Eccellente	Il sistema non è sovraccaricato ma questo non penalizza particolarmente l'utilizzo del dispositivo. Il sistema di sicurezza di emergenza dello sportello della pompa risulta estremamente facile e intuitivo di emergenza.				5,4
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia che l'assistenza tecnica non è disponibile nel fine settimana. Piano di formazione Resiliente, finalizzato a guidare. Tempo intervento entro 9 h e risoluzione entro 72 h (con disponibilità immediata di un tecnico).				4,8

Dutt_1	Dutt_2	Dutt_3
0.80	0.80	0.80
1.00	1.00	1.00
0.80	0.80	0.80
1.00	1.00	1.00
0.90	0.90	0.90
0.80	0.80	0.80
0.80	0.80	0.80
0.90	0.90	0.90
0.90	0.90	0.90
1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00
0.90	0.90	0.90
0.80	0.80	0.80

[illegible]

Datt. 1	Datt. 2	Datt. 3
0.50	0.50	0.50
0.80	0.80	0.80
0.80	0.80	0.80
0.70	0.70	0.70
0.60	0.60	0.60
0.80	0.80	0.80
0.90	0.90	0.90
0.90	0.90	0.90
0.60	0.60	0.60
1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00
0.90	0.90	0.90
0.50	0.50	0.50

[illegible]

Dott. 1	Dott. 2	Dott. 3
1.00	1.00	1.00
0.80	0.80	0.80
0.60	0.60	0.60
0.40	0.40	0.40
0.20	0.20	0.20
0.60	0.60	0.60
0.80	0.80	0.80
0.90	0.90	0.90
1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00
0.90	0.90	0.90
0.80	0.80	0.80

[illegible][illegible]

Gradimento	Attività 3.1		Punti
	Mediazione		
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenziano le seguenti caratteristiche: il motore è di tipo 4 cilindri a 2.85 hp e il peso è di 285 kg. Viene fornito con maniglia di richiamo che però non è integrata.		3,6
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenziano le seguenti caratteristiche: il motore è di tipo 4 cilindri a 2.85 hp e il peso è di 285 kg. Viene fornito con maniglia di richiamo che però non è integrata.		5
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia la presenza di occlusione su 15 livelli da 5 mm/s (1 MPa) a 115 mm/s (150 MPa).		6
Eccellente	La velocità Q3000 è programmata a 0,5 m/s, modificabile da 0,03 a 5,0 m/s con incremento di 0,1 m/s. La pompa funziona per 30 minuti a una velocità Q3000 al termine della quale essa interrompe l'infusione, all'arresto on advice Q3000 fermata.		3,6
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia la presenza di occlusione su 15 livelli da 5 mm/s (1 MPa) a 115 mm/s (150 MPa).		4,5
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia la presenza di occlusione su 15 livelli da 5 mm/s (1 MPa) a 115 mm/s (150 MPa).		5
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia che il parametro si trova di funzionamento di 43,1 ore a 2,5 ml/h per la pompa automatica di infusione e riciclaggio che a capacità piena è di circa 4 ore.		5
Eccellente	Precisione di infusione pillolema 4,5%.		6
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia che il parametro si trova di funzionamento di 43,1 ore a 2,5 ml/h per la pompa automatica di infusione e riciclaggio che a capacità piena è di circa 4 ore.		5
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro non si segnalano criticità in merito ai consumi/tempi forniti.		6
Eccellente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro non si segnalano criticità in merito ai consumi/tempi forniti.		7
Molto buono	Il sistema non presenta non rifiuta di aprire apertura. La pompa non può essere aperta con consensuale inserimento ma si mette in standby il sistema è servosicuro.		4,8
Sufficiente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si evidenzia che non risulta particolarmente dettagliato il progetto di assistenza ma viene data l'assistenza a richiesta e il sistema è servosicuro. Tale assistenza è dettagliata non permette di assistenza dettagliata. Tale assistenza è dettagliata non permette di assistenza dettagliata.		3

Don't_1	Don't_2	Don't_3
0.90	0.90	0.90
1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00
0.90	0.90	0.90
0.90	0.90	0.90
1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00
0.80	0.80	0.80
0.50	0.50	0.50

John D. Cairns, Jr.

[illegible]

DESEGNAZIONE IN ACCORDO QUANDO SENZA PRESSIONE MINIMA DI ASSEGNAZIONE			
LOTTO 4 - POMPE A SIRINGA PER TARGET CONTROLLED INFUSION (TCI)			
N. PAR.	PARAMETRO	PUNTEGGIO	CRITERIO
1	Libreria farmaci a relative software fornito	15	Verrà accordata preferenza all'offerta che presenti il maggior numero di farmaci più estesa, il numero maggiore di modelli farmacocinetici e di semplice utilizzo
2	Possibilità di visualizzazione su display del grafico della concentrazione ematica attuale, quella desiderata, la concentrazione al dosi effettore e il tempo previsto di risveglio	12	Verrà accordata preferenza all'offerta che presenti sul display la possibilità di visualizzare la visualizzazione del grafico della concentrazione ematica attuale, quella desiderata, la concentrazione al dosi effettore e il tempo previsto di risveglio
3	Facilità d'uso	11	Verrà accordata preferenza all'offerta che presenti una maggior facilità d'uso in termini di, tra gli altri ma non solo, maggior numero di opzioni di programmazione, alle possibilità di passaggio in automatico dall'iniezione da una pompa ad una seconda, alla possibilità di ricarica più breve e maggior autonomia di funzionamento della siringa, all'interfaccia utente intuitiva e arricchibile e ancoraggio al sistema scatto agevole e sicuro
4	Compatibilità con il maggior numero di siringhe possibili in commercio	10	Verrà accordata preferenza all'offerta che presenti il maggior numero di siringhe idonee all'uso con la pompa proposta
5	Altre caratteristiche della pompa: display, presenza di alimentatore interno, tempi di ricarica e autonomia batteria, facilità di pulizia	10	Verrà accordata preferenza all'offerta che presenti un display maggiormente visibile e luminoso, con caratteri facilmente leggibili, che presenti l'alimentatore interno e con tempi di ricarica più brevi e maggior autonomia di funzionamento a batteria nonché più facilmente pulibile e sanificabile
6	Software di visualizzazione in remoto della funzionalità della pompa	5	Verrà accordata preferenza all'offerta che presenti un software di visualizzazione in remoto della funzionalità della pompa completa e di facile utilizzo.
7	Relazione tecnica con particolare riferimento a: - caratteristiche del piano di assistenza per la sicurezza e la manutenzione full risk dei dispositivi offerti; - piani di addestramento e formazione proposti agli operatori sanitari; - innovazioni tecnologiche e proposte migliorative.	7	Verrà accordata preferenza all'offerta che presenti: Relazione tecnica maggiormente completa e dettagliata con riguardo al servizio di manutenzione full risk proposto (numero, operatori sul territorio, tempi di intervento, numeri rispetto a quelli previsti, call center, ecc.); Relazione tecnica maggiormente completa e dettagliata con riguardo il piano di addestramento e formazione (proposto agli operatori sanitari (numero di formatori, materiali proposti, ecc.); Numero e qualità delle innovazioni tecnologiche e proposte migliorative; rispetto a quanto richiesto (quali tra le altre e non solo scandisce lettura di qr code, aggiornamento sistema di localizzazione e tracciabilità etc.)
		70	

Classifica	Efficienza
Eccellente	0,50
Eccezionale	0,9
Molto buono	0,8
Buono	0,7
Almeno buono	0,6
Sufficiente	0,5
Nono	0,4
Molto scarso	0,3
Insufficiente	0,2
Mala valutazione	0,1
Assolutamente inadeguato	0

ICU MEDICAL EUROPE SRL		
Situazione	Motivazione	Punti
Sufficiente	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala 2 Farmaci di cui 4 modelli per il Propofol e un modello per Remifentanyl	7,5
Eccezionale	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala che il dispositivo presenta la possibilità di visualizzare sul display il grafico della concentrazione ematica attuale, quella desiderata, la concentrazione al dosi effettore e il tempo previsto di risveglio. Ottima qualità dei dati visualizzati.	10,8
Molto buono	Valutato quanto richiesto si evidenzia che l'interfaccia del dispositivo è intuitiva. L'inserimento della siringa non può essere svolto agevolmente con una sola mano.	8,8
Eccezionale	Le siringhe testate sono 154 con volumi che vanno da 2 a 60 ml.	10
Eccezionale	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala che il display è ben visibile e luminoso, i colori, touch screen, con caratteri facilmente leggibili, che presenti l'alimentatore interno e con tempi di ricarica più brevi e maggior autonomia di funzionamento a batteria nonché più facilmente pulibile e sanificabile	10
Buono	Il prodotto offerto non offre la presenza di un sistema wi-fi integrato mentre risulta presente il software per la visualizzazione da remoto della funzionalità e tracciabilità.	3,5
Buono	Valutato tutto quanto richiesto si evidenzia che l'assistenza tecnica non è disponibile nel fine settimana. Piano di formazione flessibile illimitato e gratuito.	4,9
PUNTEGGIO TOTALE: RIPARAMETRIZZAZIONE:		55,90 63,58

Dott. 1	Dott. 2	Dott. 3	Dott. 4	Dott. 5	Media
0,50	1,00	0,50	0,50	0,50	0,5
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,8
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1
0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,5
0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,7

BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.		
Situazione	Motivazione	Punti
Eccezionale	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala 5 farmaci per un totale di 11 modelli.	15
Eccezionale	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala che il dispositivo presenta la possibilità di visualizzare sul display il grafico della concentrazione ematica attuale, quella desiderata, la concentrazione al dosi effettore e il tempo previsto di risveglio. Ottima qualità dei dati visualizzati.	10,8
Eccezionale	Valutato quanto richiesto si evidenzia che l'interfaccia del dispositivo è intuitiva. L'inserimento della siringa è agevole può essere svolto agevolmente con una sola mano.	9,9
Buono	30 siringhe da 5 a 60 ml.	7
Eccezionale	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala che il parametro è di 1 a 5 ml/h (ricarica in 2,5 h).	9
Eccezionale	Il prodotto presenta wi-fi integrato, rilevazione e visualizzazione da remoto.	4,5
Buono	Valutato tutto quanto richiesto si evidenzia che l'assistenza tecnica è offerta lunedì - venerdì 8/17. Piano di formazione flessibile illimitato e gratuito.	4,9
PUNTEGGIO TOTALE: RIPARAMETRIZZAZIONE:		63,10 70,00

Dott. 1	Dott. 2	Dott. 3	Dott. 4	Dott. 5	Media
1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,7
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,7

FRESenius KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCCO		
Situazione	Motivazione	Punti
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala 4 farmaci e 7 modelli.	12
Eccezionale	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala che il display è ampio, retroilluminato, non a colori, non touchscreen con grafico della concentrazione ematica ben visibile.	10,8
Eccezionale	Valutato tutto quanto richiesto si evidenzia che l'interfaccia del dispositivo è intuitiva. L'inserimento della siringa è agevole può essere svolto agevolmente con una sola mano.	9,9
Molto buono	circa 100 tipologie da 5 a 60 ml.	8
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala che la ricarica è di 8 ore -> da 1 a 3 ml/h.	8
Eccezionale	Il prodotto presenta wi-fi integrato, rilevazione e visualizzazione da remoto.	4,5
Abbastanza buono	Valutato tutto quanto richiesto si evidenzia che l'assistenza tecnica è offerta lunedì - venerdì 8/17. Piano di formazione flessibile illimitato e gratuito presenza di specialisti per formazione sul campo anche in contesto operativo.	4,2
PUNTEGGIO TOTALE: RIPARAMETRIZZAZIONE:		57,40 65,76

Dott. 1	Dott. 2	Dott. 3	Dott. 4	Dott. 5	Media
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,8
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,8
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,6

Artiva 8.1.1		
Situazione	Motivazione	Punti
Abbastanza buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala 3 farmaci e 6 modelli.	9
Eccezionale	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala che il display è ampio, retroilluminato, a colori, non touchscreen con grafico della concentrazione ematica ben visibile.	10,8
Eccezionale	Valutato tutto quanto richiesto si evidenzia che l'interfaccia del dispositivo è intuitiva. L'inserimento della siringa è agevole può essere svolto agevolmente con una sola mano.	9,9
Molto buono	100 tipologie da 5 a 60 ml.	8
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala che la ricarica è di 8 ore durata 8 h a 5 ml/h. La modalità di spegnimento del display non è di agevole rimozione pregiudicando la pulizia.	8
Inadeguato	Il prodotto presenta wi-fi integrato, rilevazione e visualizzazione da remoto. Il software è aperto, concede possibilità di controllo e visualizzazione dispositivi di terze parti	1
Buono	Valutato tutto quanto richiesto si evidenzia che l'assistenza tecnica è offerta lunedì - venerdì 8/17. Piano di formazione flessibile illimitato e gratuito presenza di specialisti per formazione sul campo anche in contesto operativo.	4,9
PUNTEGGIO TOTALE: RIPARAMETRIZZAZIONE:		51,60 66,97

Dott. 1	Dott. 2	Dott. 3	Dott. 4	Dott. 5	Media
0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,6
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,7

Medica srl		
Situazione	Motivazione	Punti
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala 4 farmaci (Propofol, Sufentanil, Alfentanil, Remifentanyl) 8 modelli.	12
Eccezionale	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala che il display è ampio, retroilluminato, a colori, touchscreen con grafico della concentrazione ematica piccolo.	10,8
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto si evidenzia che l'interfaccia del dispositivo è intuitiva. L'inserimento della siringa è agevole può essere svolto agevolmente con una sola mano necessario sospendere momentaneamente l'iniezione.	8,8
Eccezionale	56 da 1 a 60 ml (modificabilità dei marchi delle siringhe presenti dichiarata in relazione tecnica).	9
Eccezionale	Valutato tutto quanto richiesto dal parametro si segnala che la ricarica è di 8 ore durata >12 h a 5 ml/h.	9
Eccezionale	Il prodotto presenta wi-fi integrato, rilevazione e visualizzazione da remoto. Il software è aperto, concede possibilità di controllo e visualizzazione dispositivi di terze parti	5
Molto buono	Valutato tutto quanto richiesto si evidenzia che il servizio call center è offerto lunedì venerdì 8:30-18:00. Il servizio assistenza ha reperibilità 24 h (tecnici territorio lunedì venerdì 8-19 e sabato 8-12. Piano di formazione flessibile illimitato e gratuito presenza di specialisti per formazione sul campo anche in contesto operativo.	5,6
PUNTEGGIO TOTALE: RIPARAMETRIZZAZIONE:		60,20 68,97

Dott. 1	Dott. 2	Dott. 3	Dott. 4	Dott. 5	Media
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,8
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9
0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,9

Stell D Gini R, Z

Lotto 2 - ACCORDO QUADRO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo quadriennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria	Offerta Anomala	Importo a base d'asta quadriennale €	% di ribasso	Differenza rispetto alla B.A. €	Aggiudicazione totale per art. 80 ex art. 35 €
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	67,94	6.445.050,00	29,57	97,51	1	X	11.758.080,00	45,19	5.313.030,00	7.250.681,25
Arthya S.r.l.	70,00	8.162.880,00	26,30	96,30	2	X	11.758.080,00	30,58	3.595.200,00	9.183.240,00
A.d.M.	58,50	6.182.802,00	30,00	88,50	3	X	11.758.080,00	47,42	5.575.278,00	6.955.652,25
CODAN s.r.l.	67,50	10.968.150,00	16,69	84,19	4		11.758.080,00	6,72	789.930,00	12.339.168,75
VERSAN & DAFNE MD SRL	59,58	11.549.730,00	11,19	70,77	5		11.758.080,00	1,77	208.350,00	12.993.446,25

Lotto 3 - ACCORDO QUADRO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo quadriennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria	Offerta Anomala	Importo a base d'asta quadriennale €	% di ribasso	Differenza rispetto alla B.A. €	Aggiudicazione totale per art. 80 ex art. 35 €
Medica srl	70,00	5.996.759,00	29,05	99,05	1	X	7.426.365,00	19,25	1.429.606,00	6.746.353,88
FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	68,36	5.834.909,00	30,00	98,36	2	X	7.426.365,00	21,43	1.591.456,00	6.564.272,63
ICU MEDICAL EUROPE SRL	63,57	6.164.751,00	27,98	91,55	3	X	7.426.365,00	16,99	1.261.614,00	6.935.344,88
Arthya S.r.l.	64,77	6.368.940,00	26,54	91,31	4	X	7.426.365,00	14,24	1.057.425,00	7.165.057,50
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	68,69	6.828.960,00	22,36	91,05	5	X	7.426.365,00	8,04	597.405,00	7.682.580,00
CODAN s.r.l.	65,53	7.401.787,90	8,59	74,12	6	X	7.426.365,00	0,33	24.577,10	8.327.011,39

Lotto 4 - ACCORDO QUADRO

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	PUNTEGGIO QUALITA' EVENTUALMENTE RIPARAMETRATO	Importo complessivo quadriennale offerto (IVA esclusa)	PUNTEGGIO PREZZO	PUNTEGGIO TOTALE	Graduatoria	Offerta Anomala	Importo a base d'asta quadriennale €	% di ribasso	Differenza rispetto alla B.A. €	Aggiudicazione totale per art. 80 ex art. 35 €
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	70,00	478.224,00	28,93	98,93	1	X	708.480,00	32,50	230.256,00	538.002,00
Medica srl	68,97	471.139,20	29,20	98,17	2	X	708.480,00	33,50	237.340,80	530.031,60
ICU MEDICAL EUROPE SRL	63,58	448.704,00	30,00	93,58	3	X	708.480,00	36,67	259.776,00	504.792,00
FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	65,76	543.168,00	26,20	91,96	4	X	708.480,00	23,33	165.312,00	611.064,00
Arthya S.r.l.	59,12	543.168,00	26,20	85,32	5	X	708.480,00	23,33	165.312,00	611.064,00

Totale aggiudicazione (sul 1° class.) per il quadriennio €	Proroga semestrale €	Differenza con B.A. per il quadriennio €	Aggiudicazione totale per art. 80 ex art. 35 €	Importo a base d'asta quadriennale €	Risparmio quadriennale sulla B.A. %
12.920.033,00	1.615.004,13	6.972.892,00	14.535.037,13	19.892.925,00	35,05

RAGIONE SOCIALE CONCORRENTE	Importo complessivo quadriennale offerto (IVA esclusa) €	Importo complessivo proroga semestrale (IVA esclusa) €	Aggiudicazione totale per art. 80 ex art. 35 €	Lotto di riferimento	Totale complessivo per ditta €
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	6.445.050,00	805.631,25	7.250.681,25	2	15.471.263,25
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	6.828.960,00	853.620,00	7.682.580,00	3	
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A.	478.224,00	59.778,00	538.002,00	4	
Arthya S.r.l.	8.162.880,00	1.020.360,00	9.183.240,00	2	16.959.361,50
Arthya S.r.l.	6.368.940,00	796.117,50	7.165.057,50	3	
Arthya S.r.l.	543.168,00	67.896,00	611.064,00	4	
A.d.M.	6.182.802,00	772.850,25	6.955.652,25	2	6.955.652,25
CODAN s.r.l.	10.968.150,00	1.371.018,75	12.339.168,75	2	20.666.180,14
CODAN s.r.l.	7.401.787,90	925.223,49	8.327.011,39	3	
VERSAN & DAFNE MD SRL	11.549.730,00	1.443.716,25	12.993.446,25	2	12.993.446,25
Medica srl	5.996.759,00	749.594,88	6.746.353,88	3	7.276.385,48
Medica srl	471.139,20	58.892,40	530.031,60	4	
FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	5.834.909,00	729.363,63	6.564.272,63	3	7.175.336,63
FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	543.168,00	67.896,00	611.064,00	4	
ICU MEDICAL EUROPE SRL	6.164.751,00	770.593,88	866.918,11	3	930.017,11
ICU MEDICAL EUROPE SRL	448.704,00	56.088,00	63.099,00	4	

[Handwritten signatures and initials]

**Procedura aperta telematica per la fornitura di “POMPE INFUSIONALI E
RELATIVI DEFLUSSORI E POMPE ELASTOMERICHE” IN
FABBISOGNO ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL
VENETO, PER L’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E PER ORAS S.p.A..**

1^ Edizione

**VERBALE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DEL 17 APRILE 2024**

VALUTAZIONE CONGRUITA' DELL'OFFERTA

Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2024, alle ore 14:00, presso la sede della U.O.C. CRAV di Azienda Zero, Passaggio Gaudenzio 1, Padova, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Sandra Zuzzi, procede con la valutazione della congruità dell'offerta presentata nell'ambito della procedura in intestazione.

Si dà atto che alle ditte concorrenti, sono state inviate le seguenti note, tutte datate 26/03/2024 in cui sono state chieste le giustificazioni atte a dimostrare la congruità delle offerte, e specificatamente:

- alla Ditta A.D.M. Srl è stata inviata la nota Prot. n. 7605/2024, nella quale si chiedevano le giustificazioni di congruità per il lotto n. 2 in cui è risultata terza in graduatoria;
- alla Ditta Arthya Srl è stata inviata la nota Prot. n. 7606/2024 nella quale si chiedevano le giustificazioni di congruità per i lotti nn. 2, 3 e 4 in cui è risultata rispettivamente seconda in graduatoria, quarta in graduatoria, e quinta in graduatoria;
- alla Ditta Becton Dickinson Spa Italia è stata inviata la nota Prot. n. 7604/2024 nella quale si chiedevano le giustificazioni per i lotti nn. 2, 3 e 4 in cui è risultata rispettivamente prima aggiudicataria, quinta in in graduatoria(5) e prima aggiudicataria;
- alla Ditta Codan Srl è stata inviata la nota Prot. n. 7603/2024 nella quale si chiedevano le giustificazioni per il lotto n. 3 in cui è risultata seta in graduatoria;
- alla Ditta Fresenius Kabi Italia Srl con socio unico è stata inviata la nota Prot. n. 7602/2024 nella quale si chiedevano le giustificazioni per i lotti nn. 3 e 4 in cui è risultata rispettivamente seconda in graduatoria e quarta in graduatoria;
- alla Ditta Icu Medical Srl è stata inviata la nota Prot. n. 7601/2024 nella quale si chiedevano le giustificazioni per i lotti nn. 3 e 4 in cui è risultata terza in graduatoria per entrambi i lotti;
- alla Ditta Medica Srl (costituendo ATI Medica Srl – AtesMedica Srl) è stata inviata la nota Prot. n. 7600/2024 nella quale si chiedevano le giustificazioni per i lotti nn. 3 e 4 in cui è risultata rispettivamente prima aggiudicataria e seconda in graduatoria;

I riscontri alle richieste di giustificazione sono pervenuti nei tempi richiesti.

Il Responsabile Unico del Procedimento, a fronte di quanto esposto, ritiene complessivamente non anomale e congrue le offerte presentate dalle Ditte sopra citate ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Alle ore 15:00 si chiude la seduta.

Padova, 17/04/2024

II RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

 Dott.ssa Sandra Zuzzi
